

REGISTRO:

	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ
FECHA:	18/12/2019

PRUEBA REALIZADA: GLUCOSA


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C8000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-002

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C4000
NÚMERO DE SERIE:	66100
INVENTARIO:	LRE-001

Muestra	C8000	C4000
MS1	83	84
MS2	97	100
MS3	102	103
MS4	98	100
MS5	90	91
MS6	96	97
MS7	81	83
MS8	94	94
MS9	98	99
MS10	85	87
MS11	87	89
MS12	94	95
MS13	101	101
MS14	88	89
MS15	100	100
MS16	92	92
MS17	89	91
MS18	98	100
MS19	97	97
MS20	93	94
MS21	61	63
MS22	58	59
MS23	67	69
MS24	66	68
MS25	66	68
MS26	62	62
MS27	56	57
MS28	63	64
MS29	57	58
MS30	61	61
MS31	277	280
MS32	226	228
MS33	318	321
MS34	315	314
MS35	366	377
MS36	345	348
MS37	299	304
MS38	313	312
MS39	507	512
MS40	333	337

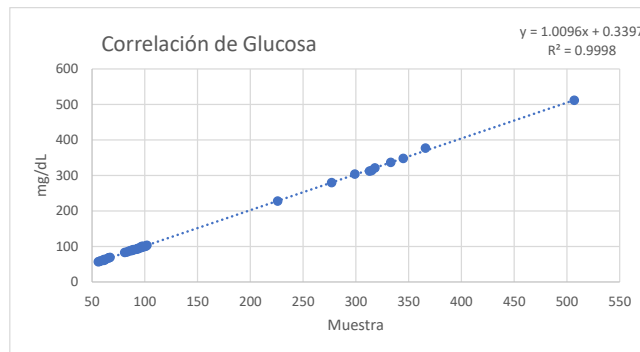

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

0.9998

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

≥ 0.9 ** ACEPTADO

REGISTRO:

	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	14/12/2019	

PRUEBA REALIZADA: TRIGLICERIDOS


DATOS DEL EQUIPO 1

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C8000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-002

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C4000
NÚMERO DE SERIE:	66100
INVENTARIO:	LRE-001

Muestra	Equipo 1	Equipo 2
MS1	121	127
MS2	128	132
MS3	104	109
MS4	116	119
MS5	116	121
MS6	122	126
MS7	117	119
MS8	121	126
MS9	145	147
MS10	106	112
MS11	116	120
MS12	122	125
MS13	115	119
MS14	124	129
MS15	126	131
MS16	125	130
MS17	107	112
MS18	117	121
MS19	121	125
MS20	120	122
MS21	51	54
MS22	68	71
MS23	55	59
MS24	61	61
MS25	48	51
MS26	71	73
MS27	49	51
MS28	36	38
MS29	62	65
MS30	43	45
MS31	719	720
MS32	429	432
MS33	340	340
MS34	422	423
MS35	700	697
MS36	485	493
MS37	370	376
MS38	841	838
MS39	527	526
MS40	438	442

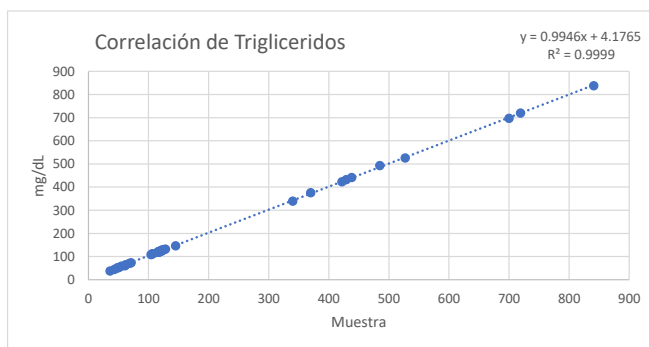

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 0.9999

CRITERIO DE ACEPTACIÓN ≥ 0.9 ** ACEPTADO

REGISTRO:

	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ
FECHA:	18/12/2019

PRUEBA REALIZADA: ÁCIDO ÚRICO


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C8000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-002

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C4000
NÚMERO DE SERIE:	66100
INVENTARIO:	LRE-001

Muestra	Equipo 1	Equipo 2
MS1	3.60	3.60
MS2	4.40	4.50
MS3	5.40	5.30
MS4	3.60	3.50
MS5	6.70	6.70
MS6	4.70	4.70
MS7	5.50	5.50
MS8	3.70	3.70
MS9	5.70	5.70
MS10	4.30	4.30
MS11	4.30	4.20
MS12	5.90	5.80
MS13	6.70	6.70
MS14	6.40	6.40
MS15	4.60	4.50
MS16	4.80	4.70
MS17	4.20	4.10
MS18	5.10	5.00
MS19	4.90	4.80
MS20	5.20	5.20
MS21	3.00	2.90
MS22	3.10	3.00
MS23	2.90	2.80
MS24	3.50	3.40
MS25	3.40	3.30
MS26	3.30	3.20
MS27	1.40	1.40
MS28	2.30	2.20
MS29	2.00	1.90
MS30	2.40	2.40
MS31	10.20	10.30
MS32	9.80	9.80
MS33	9.70	9.80
MS34	11.30	11.30
MS35	9.20	9.20
MS36	8.70	8.80
MS37	9.00	9.00
MS38	8.70	8.70
MS39	10.10	10.20
MS40	12.70	12.60

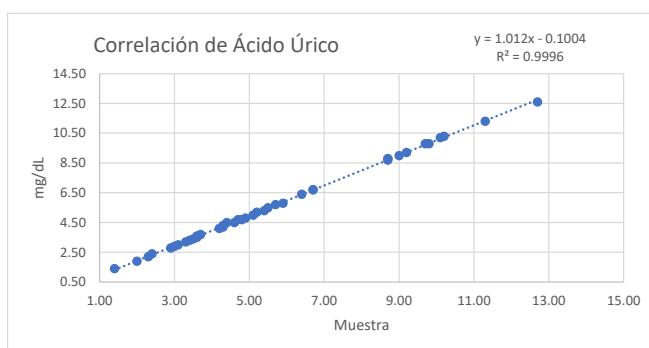

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 0.9996

CRITERIO DE ACEPTACIÓN ≥ 0.9 ** ACEPTADO

REGISTRO:

 LABORATORIO ELI	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	11/01/2020	

PRUEBA REALIZADA: CREATININA


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C8000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-002

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C4000
NÚMERO DE SERIE:	66100
INVENTARIO:	LRE-001

Muestra	Equipo 1	Equipo 2
MS1	0.71	0.73
MS2	0.58	0.60
MS3	0.73	0.75
MS4	0.72	0.73
MS5	0.64	0.68
MS6	0.62	0.65
MS7	0.82	0.83
MS8	0.79	0.80
MS9	0.69	0.73
MS10	1.03	1.06
MS11	0.93	0.96
MS12	0.54	0.56
MS13	0.93	0.95
MS14	0.80	0.81
MS15	1.05	1.09
MS16	1.09	1.12
MS17	1.02	1.05
MS18	1.03	1.01
MS19	0.85	0.86
MS20	0.87	0.86
MS21	0.47	0.48
MS22	0.35	0.35
MS23	0.35	0.37
MS24	0.43	0.44
MS25	0.47	0.48
MS26	0.37	0.38
MS27	0.39	0.41
MS28	0.37	0.38
MS29	0.40	0.40
MS30	0.43	0.44
MS31	3.18	3.17
MS32	24.43	24.36
MS33	8.28	8.29
MS34	21.19	21.21
MS35	11.17	11.19
MS36	9.29	9.13
MS37	3.87	3.81
MS38	14.14	14.12
MS39	10.57	10.56
MS40	19.52	19.62

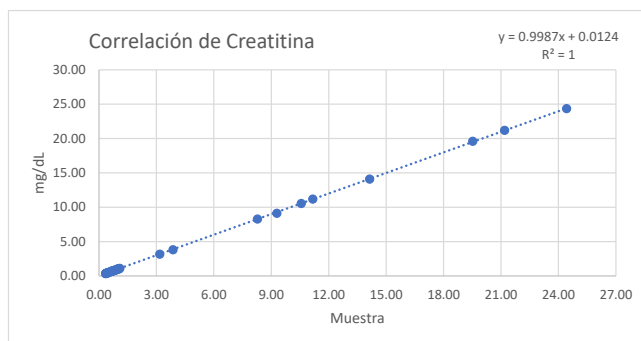

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

1

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

≥ 0.9 ** ACEPTADO

REGISTRO:

	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTINEZ	
FECHA:	20/12/2020	

PRUEBA REALIZADA: COLESTEROL


DATOS DEL EQUIPO 1

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C8000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-002

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C4000
NÚMERO DE SERIE:	66100
INVENTARIO:	LRE-001

Muestra	Equipo 1	Equipo 2
MS1	191	189
MS2	133	134
MS3	151	150
MS4	187	186
MS5	159	156
MS6	161	161
MS7	172	173
MS8	192	194
MS9	166	167
MS10	180	185
MS11	167	166
MS12	179	179
MS13	190	188
MS14	135	134
MS15	169	167
MS16	180	181
MS17	192	189
MS18	196	197
MS19	194	194
MS20	129	129
MS21	95	97
MS22	87	87
MS23	114	113
MS24	104	105
MS25	90	91
MS26	94	97
MS27	108	109
MS28	91	91
MS29	80	79
MS30	74	72
MS31	271	272
MS32	250	251
MS33	287	283
MS34	286	292
MS35	287	285
MS36	254	255
MS37	307	306
MS38	240	240
MS39	286	285
MS40	277	280

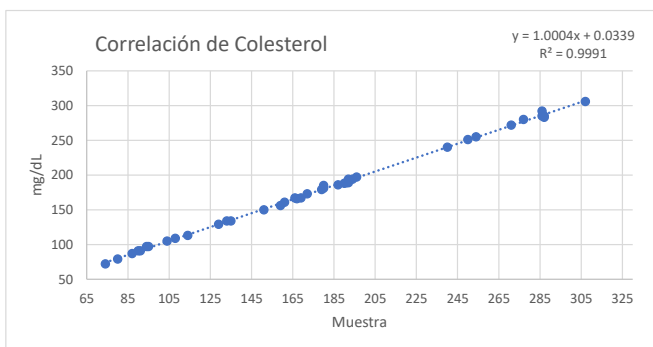

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN 0.9991

CRITERIO DE ACEPTACIÓN ≥ 0.9 ** ACEPTADO

REGISTRO:

	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA: INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	---------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	28/12/2019	

PRUEBA REALIZADA:	BUN
-------------------	-----


DATOS DEL EQUIPO 1

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C8000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-002

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	C4000
NÚMERO DE SERIE:	66100
INVENTARIO:	LRE-001

Muestra	Equipo 1	Equipo 2
MS1	14	13
MS2	14	13
MS3	14	13
MS4	12	12
MS5	21	21
MS6	20	18
MS7	13	13
MS8	17	16
MS9	19	18
MS10	14	13
MS11	17	16
MS12	16	16
MS13	12	12
MS14	17	16
MS15	15	15
MS16	14	14
MS17	10	10
MS18	16	16
MS19	12	12
MS20	15	15
MS21	29	28
MS22	38	37
MS23	72	70
MS24	47	46
MS25	44	42
MS26	32	32
MS27	121	120
MS28	78	77
MS29	56	54
MS30	77	75
MS31	8	8
MS32	7	7
MS33	8	8
MS34	9	9
MS35	5	5
MS36	4	3
MS37	8	7
MS38	5	4
MS39	6	6
MS40	5	5

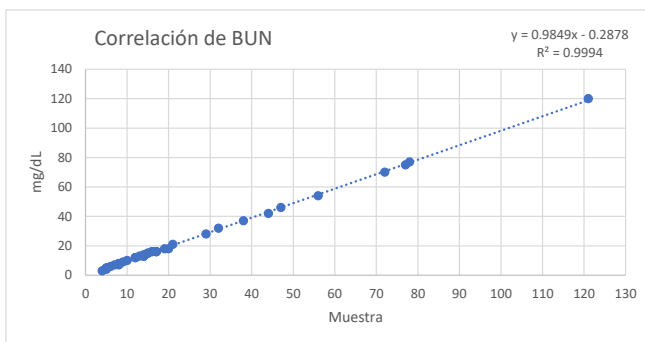

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

0.9994

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

≥ 0.9 ** ACEPTADO