

REGISTRO:

LABORATORIO ELI	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
-----------------	------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	27/12/2019	

PRUEBA REALIZADA:	FT3
-------------------	-----


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-003

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	67253
INVENTARIO:	LRE-005

Muestra	C8000	C4000
1	2.62	2.77
2	2.97	3.44
3	2.89	3.19
4	2.35	2.52
5	2.23	2.67
6	2.43	2.83
7	3.19	3.46
8	1.76	2.05
9	2.37	2.80
10	2.85	3.17
11	2.48	2.61
12	3.28	3.68
13	1.94	1.99
14	2.59	2.55
15	3.13	3.27
16	2.43	2.97
17	2.95	3.24
18	1.76	2.22
19	2.22	2.80
20	2.56	2.77
21	1.66	1.60
22	1.64	1.65
23	1.83	1.64
24	2.11	1.60
25	1.53	1.68
26	1.79	1.70
27	1.78	1.69
28	1.53	1.70
29	1.79	1.51
30	1.68	1.68
31	4.14	4.39
32	4.04	4.39
33	5.22	5.64
34	3.77	4.01
35	9.46	10.46
36	6.28	6.69
37	6.30	6.35
38	15.60	18.61
39	5.09	5.09
40	9.20	9.91

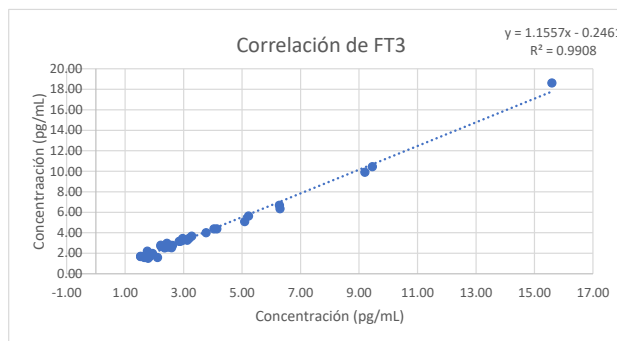

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

0.9908 ACEPTADO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

 ≥ 0.9 **

REGISTRO:

LABORATORIO ELI 	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	---------------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	29/01/2020	

PRUEBA REALIZADA:	FT4
--------------------------	------------


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-003

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	67253
INVENTARIO:	LRE-005

Muestra	C8000	C4000
1	1.12	1.06
2	0.99	1.01
3	0.99	0.90
4	1.46	1.41
5	0.92	0.82
6	1.10	1.16
7	1.07	1.03
8	1.23	1.22
9	1.14	1.11
10	1.13	1.13
11	0.94	0.89
12	1.00	0.87
13	1.00	1.00
14	0.78	0.82
15	1.00	0.95
16	1.05	1.12
17	0.99	1.02
18	1.09	0.99
19	1.08	1.07
20	1.04	1.06
21	0.67	0.63
22	0.57	0.58
23	0.65	0.52
24	0.64	0.51
25	0.42	0.52
26	0.53	0.56
27	0.57	0.53
28	0.76	0.66
29	0.70	0.60
30	0.73	0.58
31	3.48	3.39
32	4.40	4.71
33	3.79	3.84
34	2.34	1.66
35	3.73	3.89
36	1.70	1.72
37	3.38	3.95
38	1.64	1.70
39	1.66	1.66
40	4.57	3.68

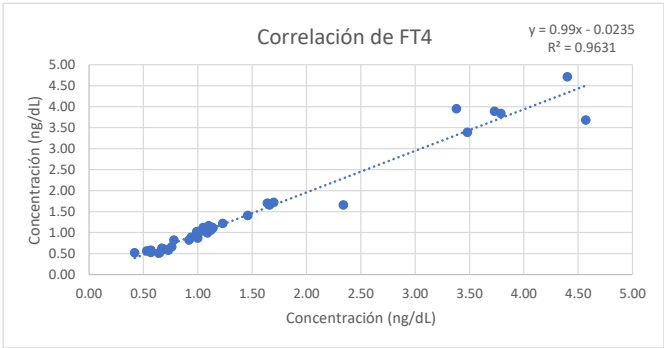

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN	0.9631 ACEPTADO
CRITERIO DE ACEPTACIÓN	≥ 0.9 **

REGISTRO:

LABORATORIO ELI 	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	30/01/2020	

PRUEBA REALIZADA: TT3


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-003

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	67253
INVENTARIO:	LRE-005

Muestra	C8000	C4000
1	1	1.13
2	0.9	0.99
3	1.01	1.06
4	1.02	1.08
5	0.92	1
6	0.77	0.87
7	1.12	1.26
8	0.97	1.04
9	1.13	1.17
10	0.9	0.96
11	1.09	1.2
12	0.72	0.85
13	1.07	1.13
14	1.1	1.21
15	1.2	1.31
16	0.92	0.96
17	1.07	1.18
18	0.96	1.06
19	1.07	1.12
20	1.04	1.12
21	0.53	0.54
22	0.46	0.57
23	0.5	0.63
24	0.43	0.45
25	0.53	0.6
26	0.54	0.59
27	0.5	0.58
28	0.41	0.47
29	0.48	0.47
30	0.5	0.56
31	1.72	1.79
32	1.62	1.71
33	3.29	3.27
34	1.84	2.03
35	1.6	1.71
36	3.39	3.63
37	3.21	3.63
38	2.89	3.08
39	3.54	3.76
40	3.69	4.18

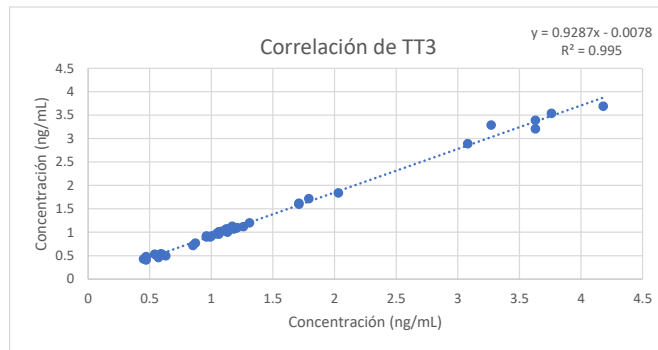

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

0.995 ACEPTADO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

 ≥ 0.9 **

REGISTRO:

LABORATORIO ELI 	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
--	-------------------------------	--------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	31/01/2020	

PRUEBA REALIZADA: TT4


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-003

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	67253
INVENTARIO:	LRE-005

Muestra	C8000	C4000
1	8.25	8.51
2	5.17	5.27
3	8.04	8.06
4	7.46	7.62
5	9.50	9.89
6	5.30	5.07
7	7.54	7.78
8	7.75	8.18
9	7.68	7.92
10	8.66	8.85
11	8.58	9.10
12	6.67	7.08
13	8.14	8.25
14	7.59	7.96
15	8.36	8.33
16	6.26	6.24
17	8.58	8.79
18	6.84	6.89
19	5.79	5.49
20	6.44	6.35
21	2.62	2.76
22	2.30	2.31
23	1.56	1.53
24	2.05	2.10
25	1.44	1.34
26	2.84	2.57
27	2.54	2.82
28	2.46	2.63
29	1.77	2.79
30	2.01	1.85
31	17.30	17.41
32	16.90	19.73
33	19.25	21.34
34	13.66	13.69
35	14.85	15.93
36	21.82	22.15
37	15.66	14.98
38	16.55	16.54
39	16.89	17.59
40	13.18	13.71

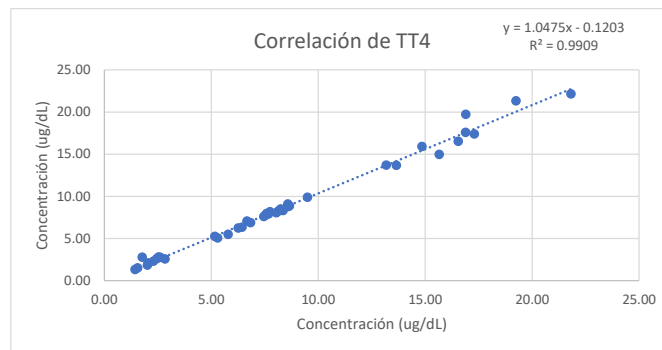

COEFICIENTE DE CORRELACIÓN

0.9909 ACEPTADO

CRITERIO DE ACEPTACIÓN

 ≥ 0.9 **

REGISTRO:

LABORATORIO ELI 	CORRELACIÓN DE MÉTODOS	AREA:INMUNOQUIMICA
---	-------------------------------	---------------------------

REALIZÓ:	T.L.C. JENNIE AGUILAR FLORES	QBP FRANCISCO HERACLEO GARCIA
SUPERVISÓ:	Q.B.P. SUSANA MARTÍNEZ	
FECHA:	16/01/2020	

PRUEBA REALIZADA: TSH


DATOS DEL EQUIPO 1

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	66035
INVENTARIO:	LRE-003

DATOS DEL EQUIPO 2

MARCA:	ABBOTT
MODELO:	i2000
NÚMERO DE SERIE:	67253
INVENTARIO:	LRE-005

Muestra	C8000	C4000
1	0.0091	0.0077
2	0.0682	0.0661
3	0.0462	0.0445
4	0.0351	0.0355
5	0.0010	0.0002
6	0.0061	0.0046
7	0.0000	0.0003
8	0.0009	0.0005
9	0.0084	0.0080
10	0.0089	0.0090
11	118.2839	119.0153
12	158.2651	153.7285
13	117.0775	112.4891
14	30.0543	26.3659
15	82.3325	84.7604
16	45.6141	45.5508
17	56.4827	55.0655
18	38.1329	30.8935
19	40.6322	38.9316
20	51.0488	49.7975
21	2.2212	2.0896
22	1.3387	1.2305
23	0.9212	0.8454
24	0.3657	0.3266
25	1.6207	1.4719
26	0.0054	0.0053
27	2.6673	2.4278
28	1.2461	1.0709
29	2.9133	2.6947
30	2.6528	2.3792
31	2.9135	2.7662
32	3.1777	2.9708
33	1.6740	1.5186
34	2.7188	2.4472
35	2.0874	1.7164
36	1.4678	1.3054
37	2.3189	2.2144
38	1.2061	1.1177
39	0.8057	0.7786
40	0.9574	0.8805

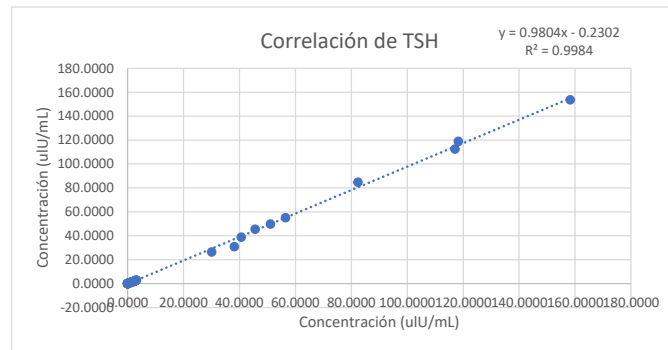**COEFICIENTE DE CORRELACIÓN**0.9984 **ACEPTADO****CRITERIO DE ACEPTACIÓN** $\geq 0.9^{**}$